

测试报告

样品信息			
样品名称	氯乙烯	编号	W202100809-005
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2021/08/09	测试期间	2021.08.09-08.10
样品描述	/		
测试需求			
测试成分	/		
参考标准			
参考标准	客户提供	标样	/
仪器信息			
测试仪器	气相色谱仪	仪器型号	磐诺


● 色谱条件：

色谱柱	月旭 WEL-PLOT Q (30m×0.53mm, 40μm) (货号：06928-52026)
柱温	160℃
进样口	200℃
检测器	FID 200℃
载气	氮气
柱流速	5.0ml/min
分流比	不分流
进样量	4.0μL
氢气	30ml/min
空气	300ml/min



注意事项

● 谱图和数据

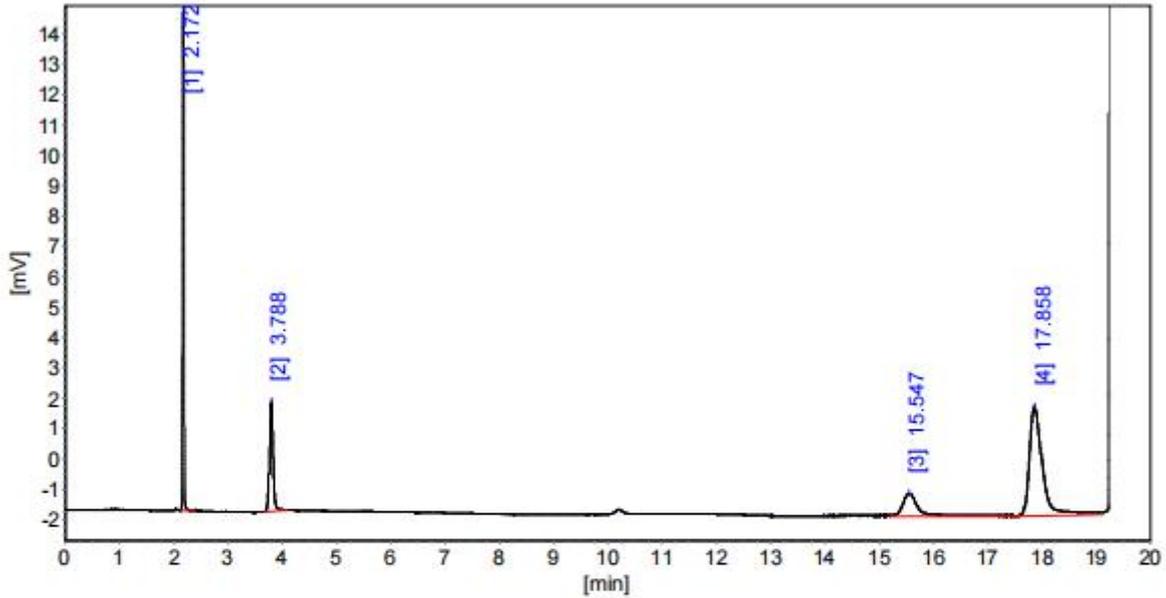

Column Performance

Column Length: 30m

Dead Time: 2.172min

No.	Compound Name	R. Time [min]	W(0.5h) [min]	α	N	Rs	Tf
1		2.172	0.02367	0.0000	46665	0.000	1.049
2		3.788	0.06607	0.7442	18216	21.254	1.148
3		15.547	0.26123	6.1580	19623	42.394	1.319
4		17.858	0.23806	7.2221	31176	5.462	1.496

● 结论

使用月旭 WEL-PLOT Q (30m×0.53mm, 40μm) (货号: 06928-52026) 色谱柱, 在此色谱条件下测定, 能满足检测的要求。

日期: 2021/08/11

第 2 页 共 2 页

