

## 测试报告

样品信息			
样品名称	盐酸普鲁卡因	编号	W20130816-001
样品重量	\	剂型	注射剂
收样日期	2013/08/16	测试期间	2013/08/16-08/29
样品描述	透明液体		
测试需求			
测试成分	含测		
参考标准			
参考标准	2010 版药典二部	标样	无
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	安捷伦 1290

## ● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Xtimate™ C18 (4.6*150mm, 5μm)
流动相:	缓冲溶液-甲醇=68:32
检测波长:	290nm
柱温:	30℃
流速:	1ml/min
进样量:	10μl
注意事项:	无

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:0579-82795008

邮编: 321016

E-mail:huanqizhong@welchmat.com

● 流动相配置:


缓冲溶液: 0.1%庚烷磺酸钠与 0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液 (用磷酸调节 pH 值 3.0) - 甲醇=68:32, 均用 0.45 $\mu$ m 滤膜过滤。

● 样品处理方法:

供试品制备: 精密量取本品加水溶解稀释为 0.02mg/ml, 过滤既得;

● 谱图和数据:

1. 供试品、

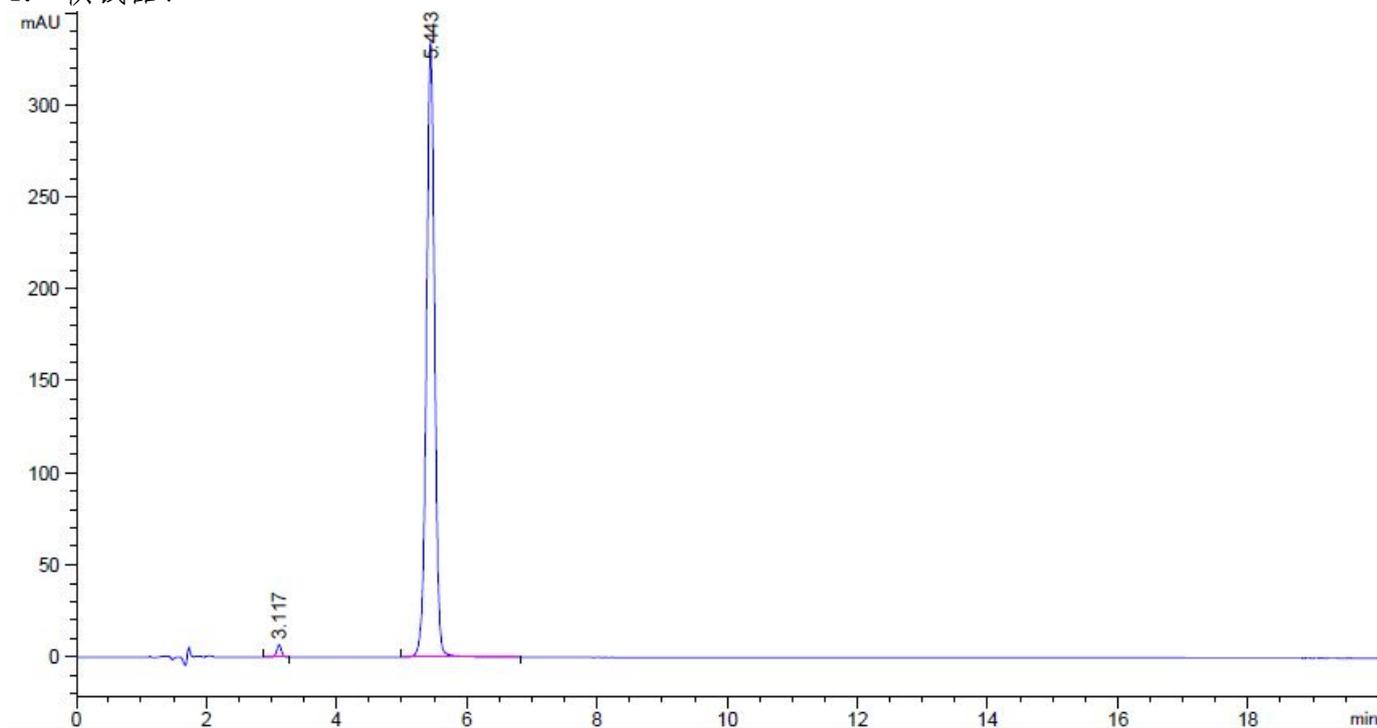

保留时间 [min]	k'	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	对称 因子	峰宽 [min]	塔板数	分离度	选择性
3.117	-	33.80756	6.73779	1.01	0.0761	9288	-	-
5.443	-	2917.28052	333.97363	0.98	0.1313	9528	13.17	1.75

报告签字

测试: 张厚才

日期: 2013/8/29

审核: 薛坤鹏

日期: 2013/8/29

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:0579-82795008

邮编: 321016

E-mail:houshizhang@welchmat.com